Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG. Lübeck

Darstellung 1
Diagram 1

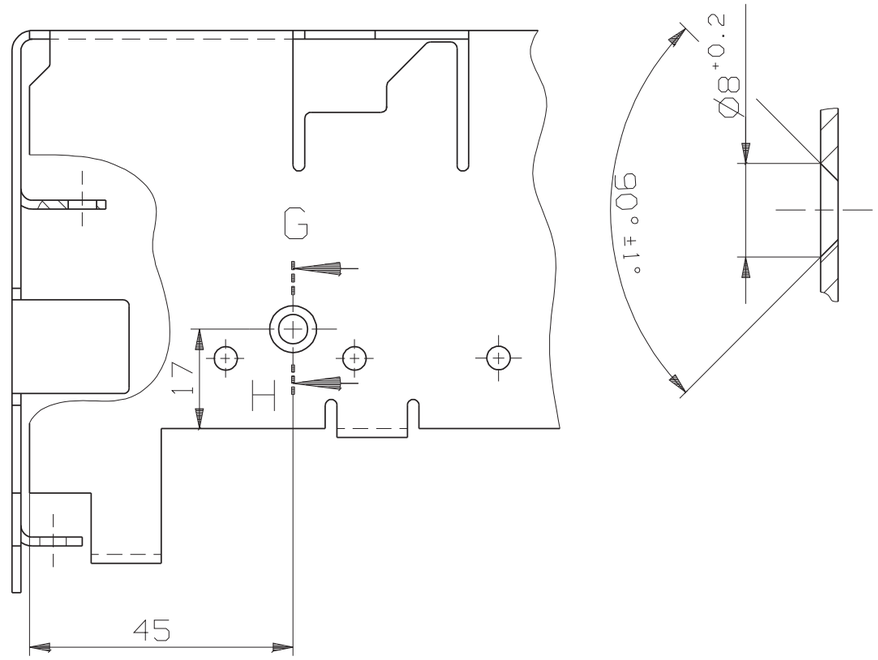

G-H M2:1

Umruestanweisung

Gueltig fur Geraete bis zur Fabrikations-Nummer ARLN 0999

1. In die Rueckwand der Regeleinheit 2M21500 eine Bohrung (4mm) mit einer Senkung (8mm) bohren. (siehe Darstellung 1)

2. Das Erdungskabel der LP-Power an den Erdungs-bolzen der Rueckwand (Regeleinheit) schrauben. (siehe Darstellung 2)

3. Bei Austausch der LP-Power Sach.-Nr. 8290641 gegen neue LP-Power 8290771 musz der 2-fach-Temperatursensor 2M20859 durch einen neuen ausgetauscht werden.

Conversion Instruction

Valid for units until serial number ARLN 0999

Due to manufacturing changes a drilling (4mm) and a sinking (8mm) have to be placed in the back panel of control unit 2M21500 in order to secure the changed heat sink of the PCP Power.

The sinking is necessary in order to keep the head of the screw from rubbing against the base of Babytherm 8000 and to keep the control unit properly clamped. The position of the drilling can be seen in Diagram 1.

The PCB Power grounding cable has to be connected to the ground stud found on the back panel of control unit 2M21500 as seen in Diagram 2.

If the PCB Power with item number 8290641 for control unit 2M21500 is replaced with the PCB Power with item number 8290771, then the 2-fold temperature sensor 2M20859 has to be replaced with a new one.

Darstellung 2
Diagram 2

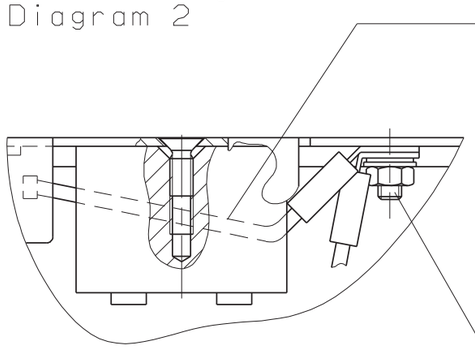

=QA=	=QB=	=QC=
--	--	--

Werkstoff: SM-Papier DIN A3 ws hf 80g/qm

Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen
01		(110/97)

Maszstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1997	Tag	Name
1 : 1	---	M2	Bearb	22.09.	Stickel
			Gepr.	22.09.	Kannengie.
				--	--

Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger

PROD	CADRA=8

Benennung: Umruestanweisung (Regeleinheit 2M21500)

Zeichnungs-Nr.: 2M21923

Ersatz fuer

Ersetzt durch